

ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΕΚΕΤΑ)/
ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΧΗΜΙΚΩΝ ΔΙΕΡΓΑΣΙΩΝ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΠΟΡΩΝ (ΙΔΕΠ)
6ο χλμ. Χαριλάου – Θέρμης
57001 ΘΕΡΜΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: κ. Π. Αμάραντος
ΑΡΙΘΜ. ΤΗΛΕΦ: 24630 55300 (εσ. 206)
ΑΡΙΘΜ. FAX: 24630 55301
e-mail: amarantos@lignite.gr

Πτολεμαΐδα, 20-02-2020
Αριθμ. Πρωτ. 43448

ΘΕΜΑ: Διευκρινίσεις για τον Ανοικτό Διαγωνισμό (Ηλεκτρονικό, κάτω των ορίων) με αντικείμενο:
«Προμήθεια αναλυτικού εξοπλισμού» και Αρ. Πρωτ. Διακήρυξης: 439/2020

Κατόπιν υποβολής ερωτήματος, μέσω της πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ, για παροχή διευκρινίσεων για το Τμήμα 5 του ανωτέρω διαγωνισμού, παρατίθενται κατωτέρω οι σχετικές διευκρινίσεις:

Ερώτημα 1


Ανταποκρινόμενοι στον διαγωνισμό με θέμα «Προμήθεια αναλυτικού εξοπλισμού» Αριθ. Διακήρυξης 439/2020 και αριθμό συστήματος 61938, με ημερομηνία κατάθεσης προσφοράς 4/3/2020 και ημερομηνία διεξαγωγής 10/3/2020, θα θέλαμε να ζητήσουμε διευκρίνηση επί μίας τεχνικής προδιαγραφής.

Ζητάμε να μας διευκρινίσετε την προδιαγραφή: του Τμήματος 5 «Σύστημα θερμικής ανάλυσης TGA/DSC» Αρ. 3 «Να έχει δύο άξονες ζύγισης (δείγματος και αναφοράς)»

Απάντηση

Με την προδιαγραφή με α/α 3 του Τμήματος 5 «Σύστημα θερμικής ανάλυσης TGA/DSC» ζητείται το προτεινόμενο σύστημα να έχει τη δυνατότητα παράλληλης τοποθέτησης (όχι στην ίδια θέση) και ακόλουθης ζύγισης τόσο του χωνευτηρίου αναφοράς όσο και του χωνευτηρίου δείγματος κατά την εκτέλεση ενός πειράματος. Με τη συγκεκριμένη προδιαγραφή αποκλείονται από προτεινόμενα τα μηχανήματα που απαιτούν δύο φορές την εκτέλεση της ίδιας δοκιμής, μία για το χωνευτήριο αναφοράς και μία για το δείγμα, καθώς καθίσταται χρονοβόρος και επίπονη η εξαγωγή των αποτελεσμάτων.

Για την Επιτροπή Διαγωνισμού

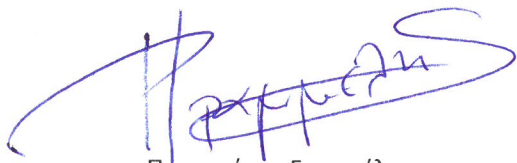

Παναγιώτης Γραμμέλης
Πρόεδρος Επιτροπής